



Prodotti **interessati** dal richiamo – lotti meno recenti del box di sterilizzazione «59S, modello S2»

- Senza sistema di chiusura magnetica
- Luci LED dorate

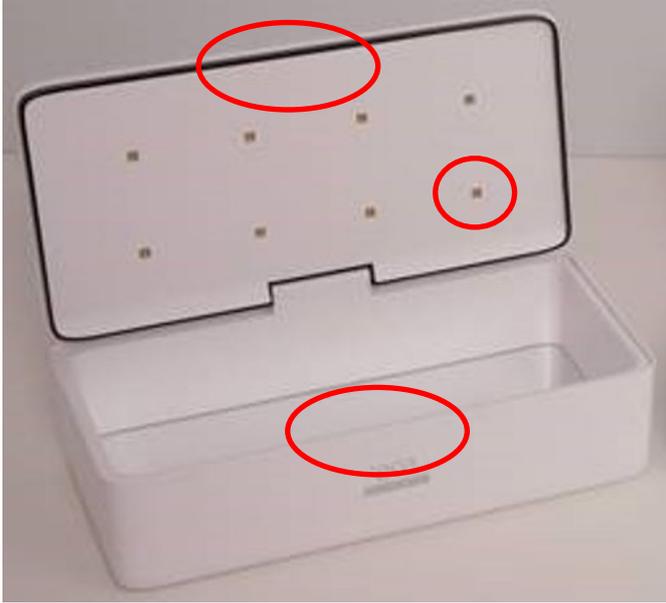


Prodotti **non** interessati dal richiamo – nuovi lotti del box di sterilizzazione «59S, modello S2»

- Con sistema di chiusura magnetica
- Luci LED argentate

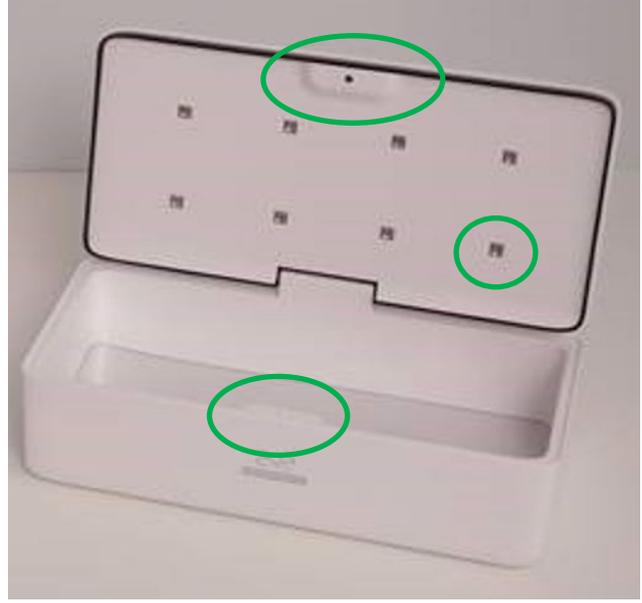


- **Linea blu luminosa continua:**

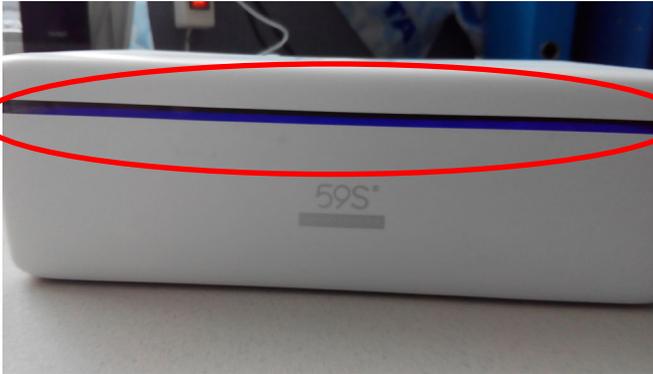

- **Linea blu luminosa discontinua**



- **Imballaggio senza il simbolo seguente:**



- **Imballaggio con il simbolo seguente:**

